


my3™ Bedieningspaneel



ON / OFF
Start en stop
uw toestel.

REPEAT
Als u de gewenste
instellingen hebt
geselecteerd kan
u het toestel aan
diezelfde instellingen
laten starten
door simpelweg
de repeat-knop te
gebruiken.

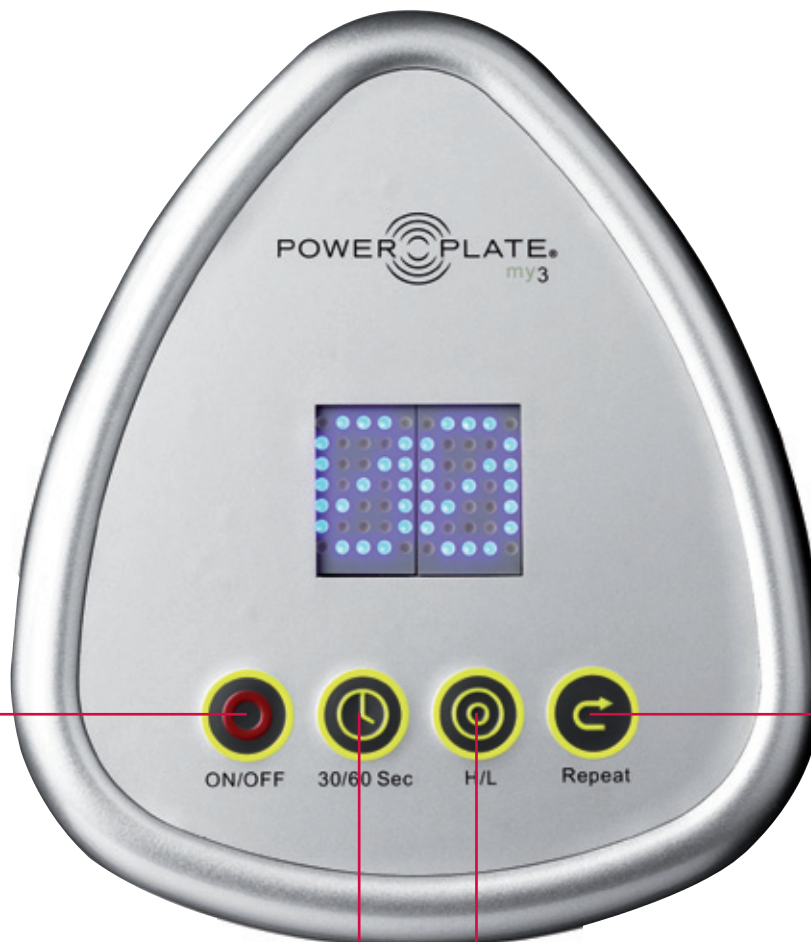

TIME
Selecteer 30 of
60 seconden met
de tijdsknop.

AMPLITUDE
De amplitude is de
hoogte van de trillingen.
Start met LOW tenzij u
een massage-oefening
uitvoert.